


Mesa acessível para pessoa em cadeira de rodas (PCR)




Atenção
Esta imagem tem caráter apenas ilustrativo. As informações relativas às especificações devem ser obtidas nas fichas técnicas correspondentes

MA-02 FDE


**Mesa
acessível
para pessoa
em cadeira
de rodas
(PCR)**

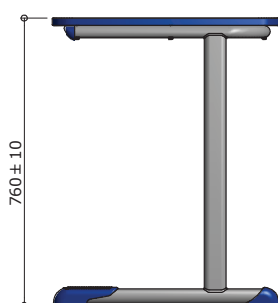

VISTA LATERAL
ESC. 1 : 20

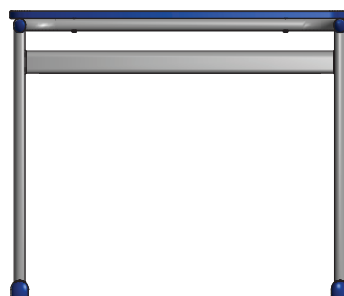

VISTA FRONTAL
ESC. 1 : 20

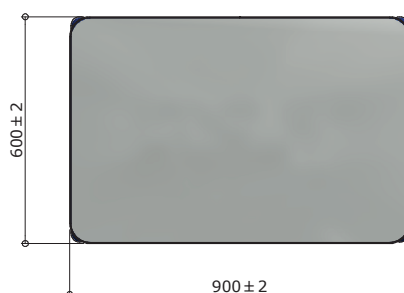

VISTA SUPERIOR
ESC. 1 : 20

Revisão 4
Data 31/07/17

Página
1/12



Atenção
Preserve a escala
Quando for imprimir, use
folhas A4 e desabilite a
função "Fit to paper"

Respeite o Meio Ambiente.
Imprima somente o ne-
cessário

MA-02
FDE


Mesa
acessível
para pessoa
em cadeira
de rodas
(PCR)

Revisão 4
Data 31/07/17


Página
2/12

Atenção
Preserve a escala
Quando for imprimir, use
folhas A4 e desabilite a
função "Fit to paper"

Respeite o Meio Ambiente.
Imprima somente o ne-
cessário

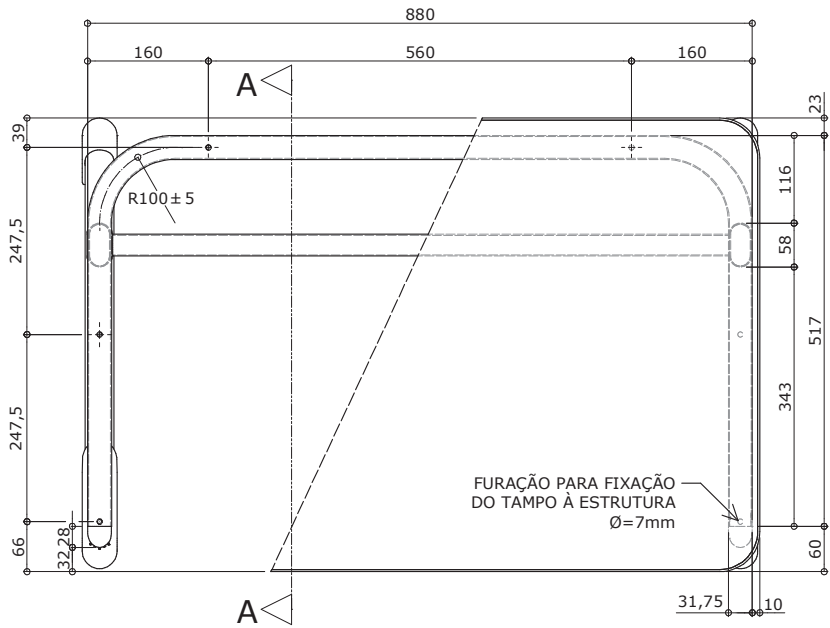


VISTA SUPERIOR
ESC. 1 : 10

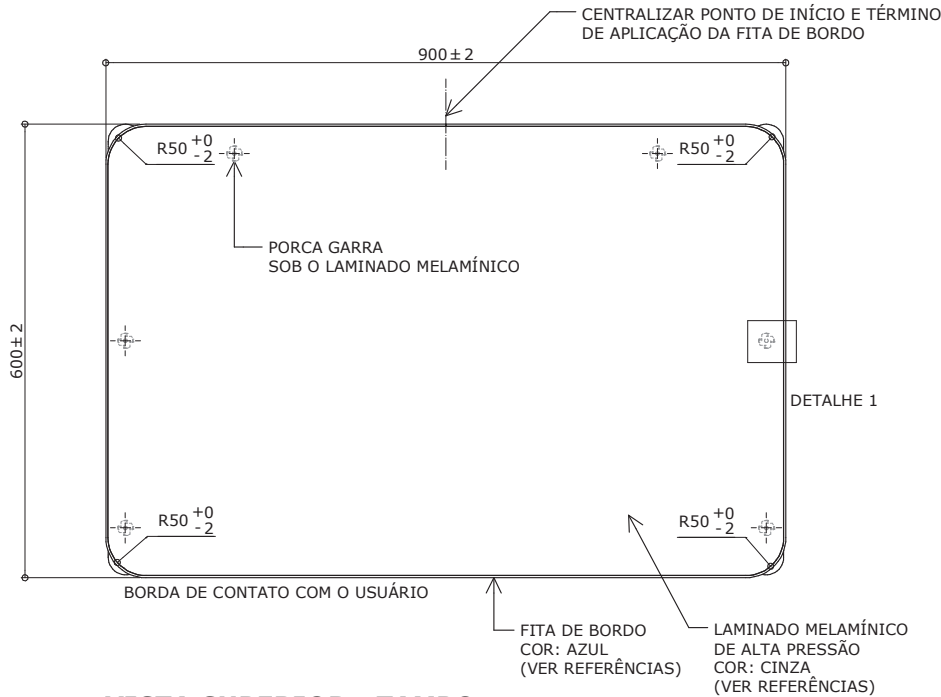


VISTA SUPERIOR - TAMPO
ESC. 1 : 10

* Projeto FDE com cessão de uso ao FNDE conforme Acordo de Cooperação Técnica (D.O.U. 25/03/2009)
medidas em milímetros

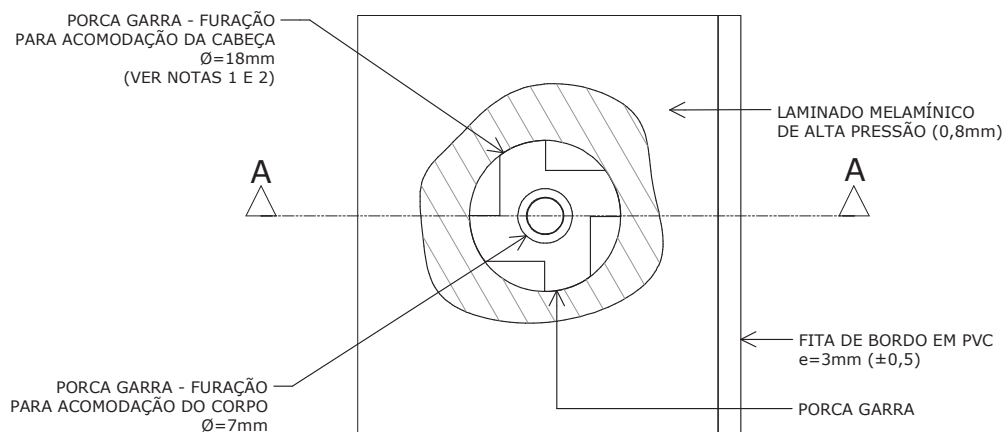


VISTA SUPERIOR

ESC. 1 : 1

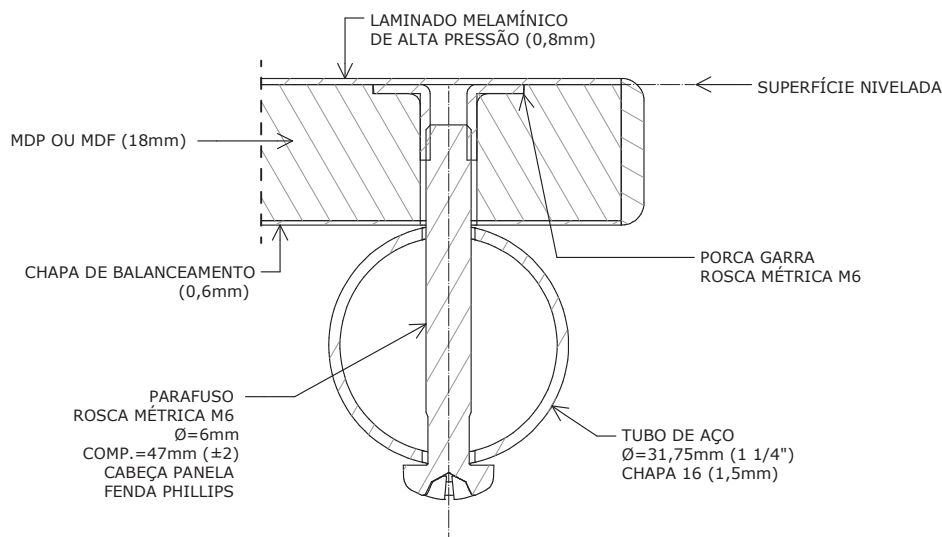

CORTE AA

ESC. 1 : 1

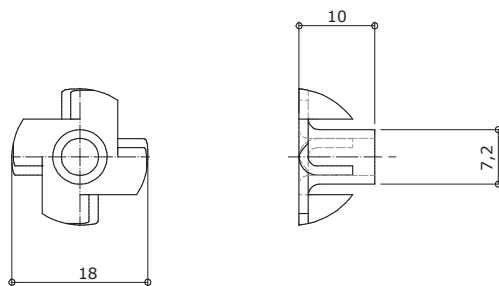

PORCA GARRA

ESC. 1 : 1

Nota 1: A furação e a aplicação da porca garra devem ser executadas antes da colagem do laminado melamínico de alta pressão.

Nota 2: A profundidade da furação deve ser a mesma da espessura da porca garra de modo que a superfície fique nivelada. É permitida a utilização de mastique elástico ou outro produto polimérico na região situada entre a superfície da porca garra e o laminado melamínico de alta pressão.

* Projeto FDE com cessão de uso ao FNDE conforme Acordo de Cooperação Técnica (D.O.U. 25/03/2009)

medidas em milímetros

MA-02 FDE

Mesa
acessível
para pessoa
em cadeira
de rodas
(PCR)

Revisão 4
Data 31/07/17

Página
3/12



Atenção

Preserve a escala
Quando for imprimir, use
folhas A4 e desabilite a
função "Fit to paper"


Respeite o Meio Ambiente.
Imprima somente o ne-
cessário

MA-02 FDE

**Mesa
acessível
para pessoa
em cadeira
de rodas
(PCR)**


Revisão 4
Data 31/07/17

Página
4/12

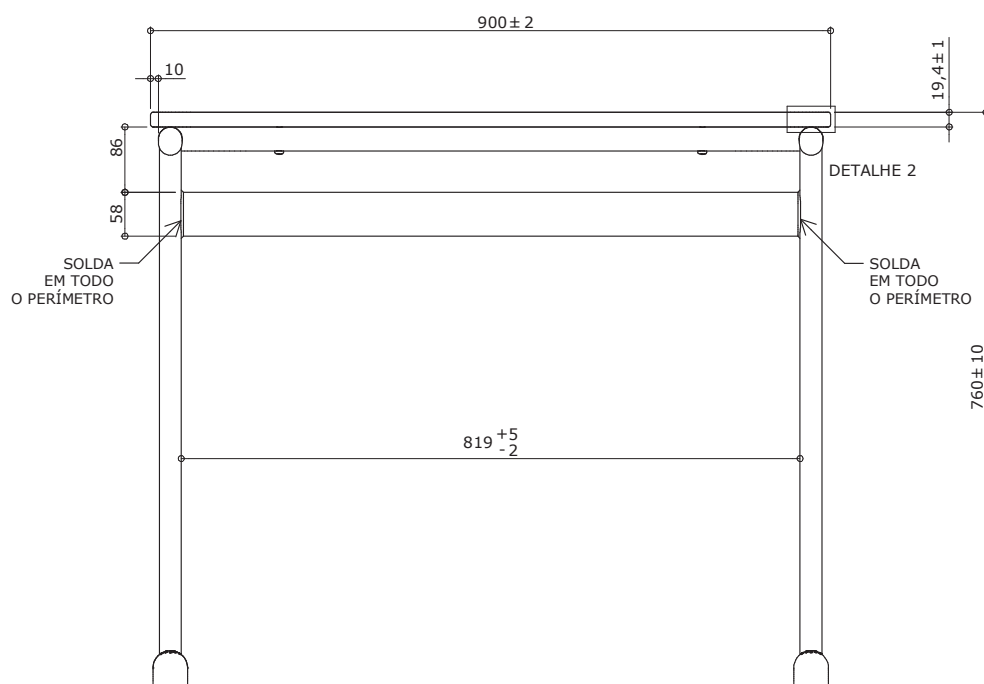

VISTA FRONTAL

ESC. 1 : 10

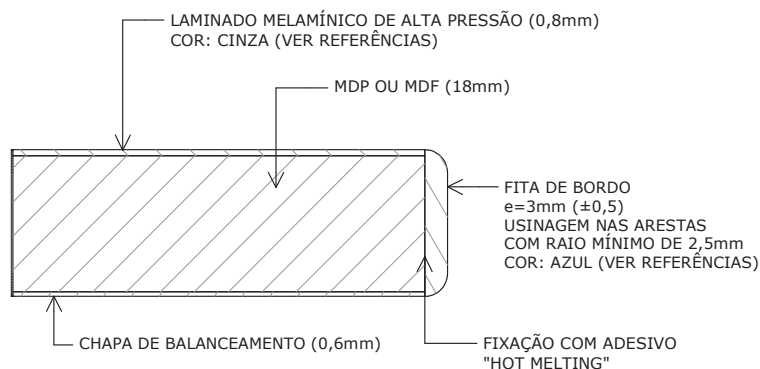

DETALHE 2

ESC. 1 : 1




Atenção
Preserve a escala
Quando for imprimir, use
folhas A4 e desabilite a
função "Fit to paper"

Respeite o Meio Ambiente.
Imprima somente o ne-
cessário

MA-02 FDE

**Mesa
acessível
para pessoa
em cadeira
de rodas
(PCR)**

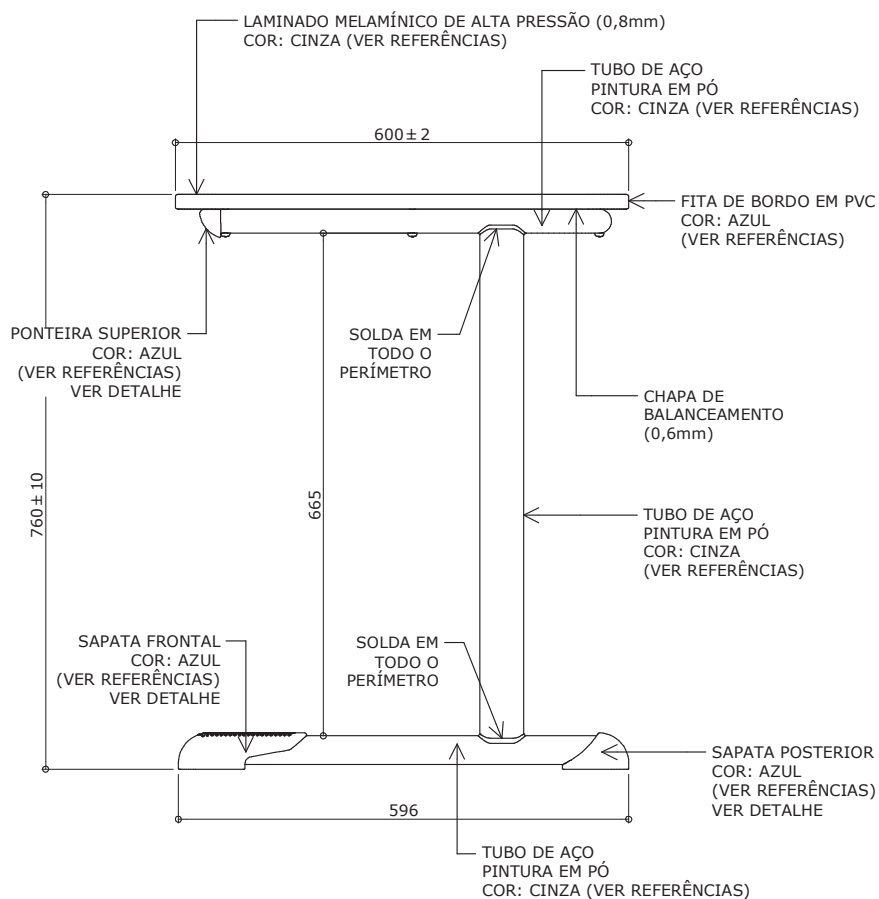

VISTA LATERAL

ESC. 1 : 10

Revisão 4
Data 31/07/17

Página
5/12



Atenção

Preserve a escala
Quando for imprimir, use
folhas A4 e desabilite a
função "Fit to paper"

Respeite o Meio Ambiente.
Imprima somente o ne-
cessário

MA-02 FDE


Mesa
acessível
para pessoa
em cadeira
de rodas
(PCR)

Revisão 4
Data 31/07/17


Página
6/12

Atenção
Preserve a escala
Quando for imprimir, use
folhas A4 e desabilite a
função "Fit to paper"

Respeite o Meio Ambiente.
Imprima somente o ne-
cessário

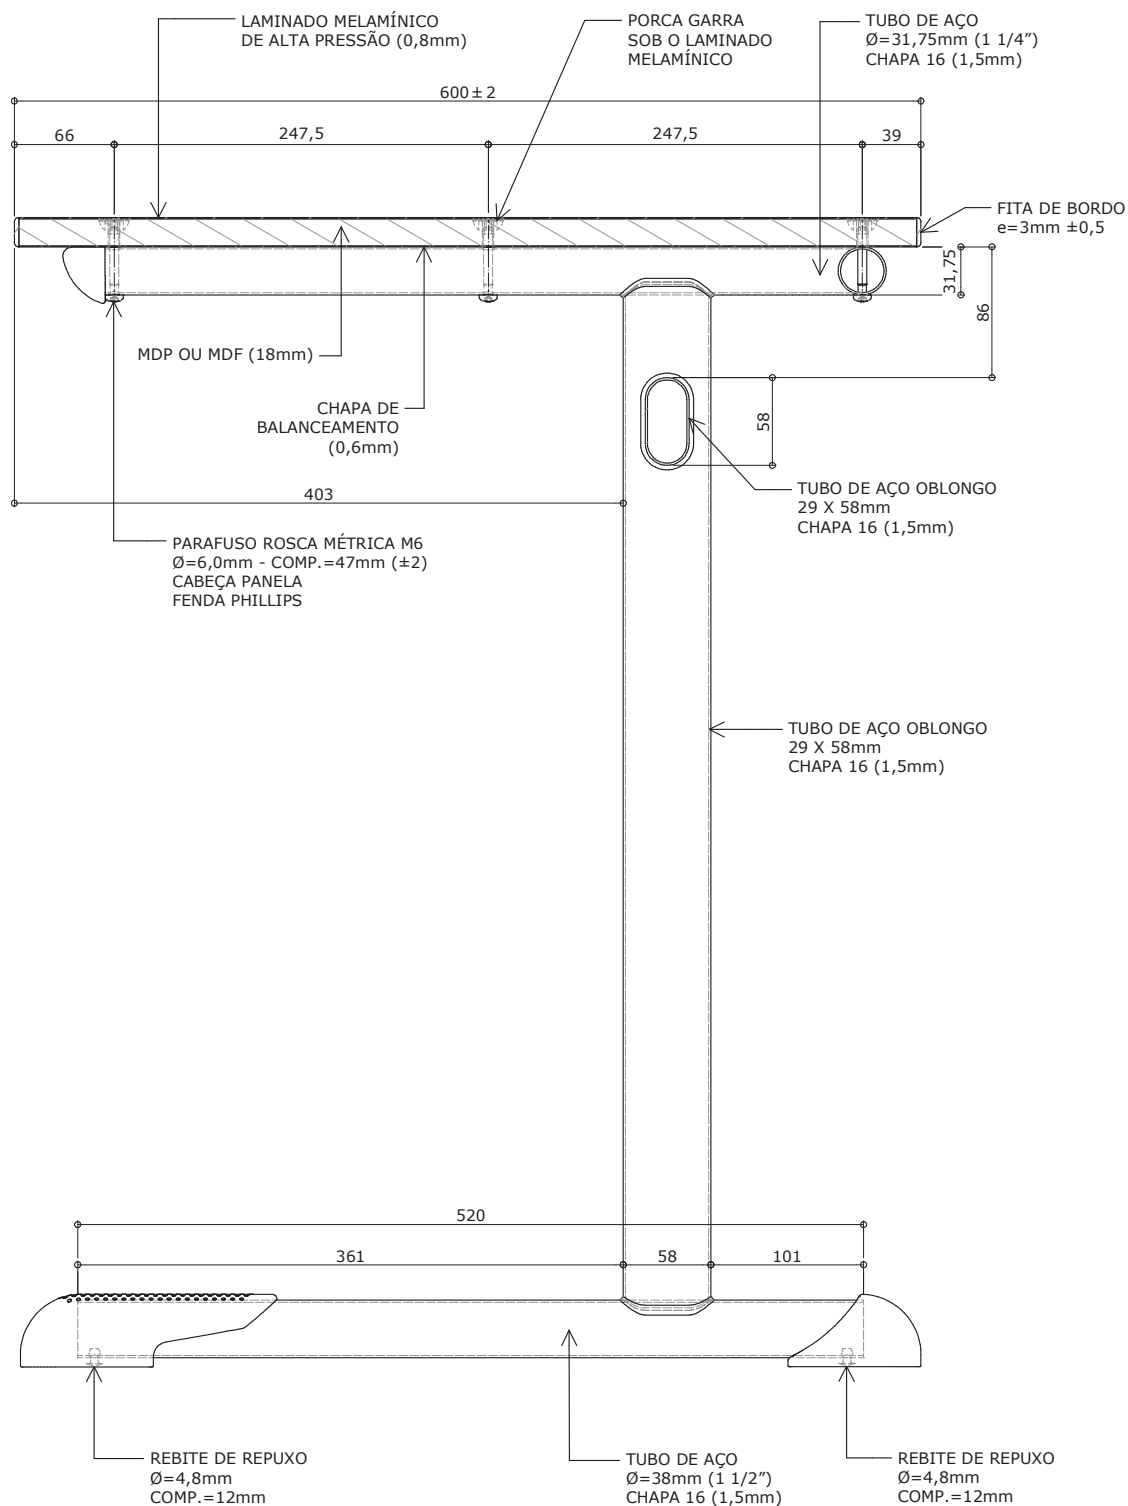


CORTE AA
ESC. 1 : 5

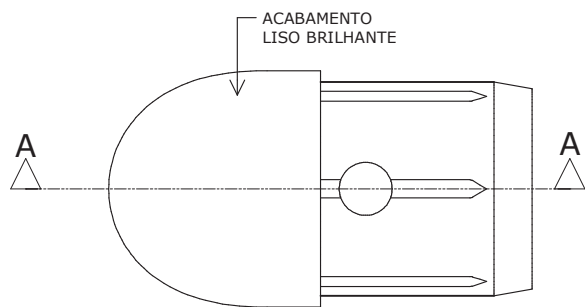


VISTA INFERIOR

ESC. 1 : 1

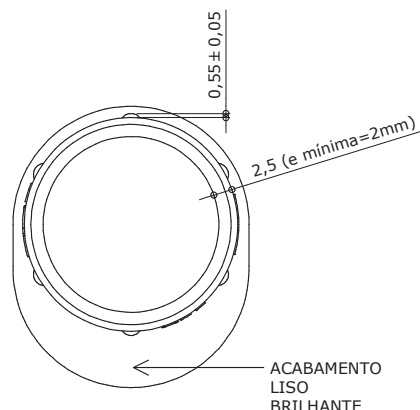

VISTA POSTERIOR

ESC. 1 : 1

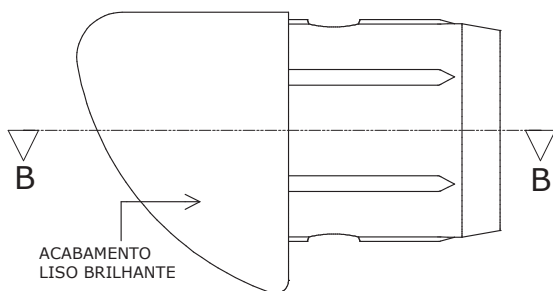


VISTA LATERAL

ESC. 1 : 1




VISTA FRONTAL

ESC. 1 : 1

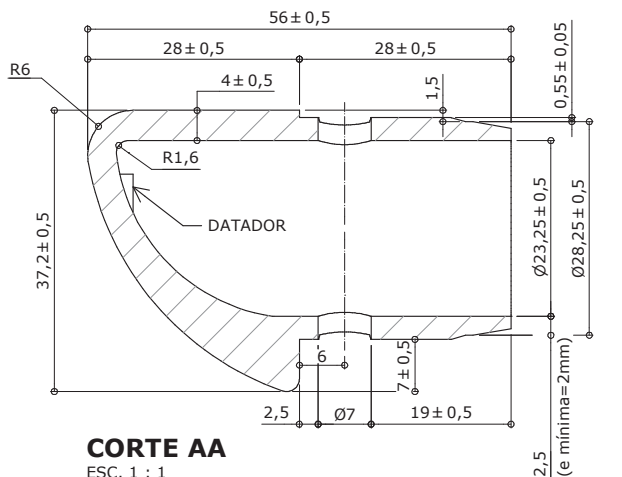

CORTE AA

ESC. 1 : 1

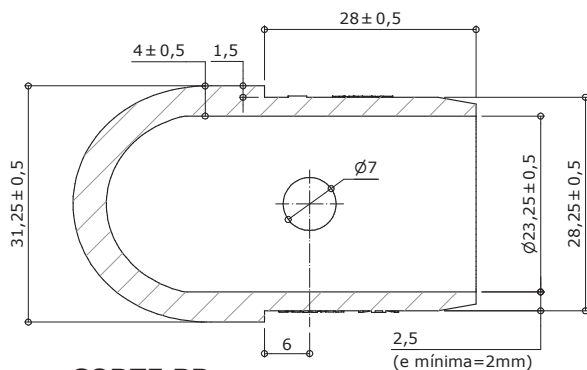

CORTE BB

ESC. 1 : 1




Apresentar em relevo no material injetado a seguinte informação:



**nome do fabricante
do componente**

Identificação do Modelo

Datador conforme figura abaixo:

Indicador
de mêsIndicador
de ano

Datador duplo com miolo giratório
D= 5 ou 6mm

MA-02
FDE

**Mesa
acessível
para pessoa
em cadeira
de rodas
(PCR)**

Revisão	4
Data	31/07/17

Página 7/12



Atenção

Preserve a escala
Quando for imprimir, use
folhas A4 e desabilite a
função "Fit to paper"

Respeite o Meio Ambiente.
Imprima somente o necessário

MA-02 FDE

Mesa
acessível
para pessoa
em cadeira
de rodas
(PCR)

Revisão 4
Data 31/07/17

Página
9/12



Atenção
Preserve a escala
Quando for imprimir, use
folhas A4 e desabilite a
função "Fit to paper"

Respeite o Meio Ambiente.
Imprima somente o ne-
cessário



Apresentar em relevo no material injetado
a seguinte informação:




nome do fabricante
do componente

Identificação do Modelo


Datador conforme figura abaixo:

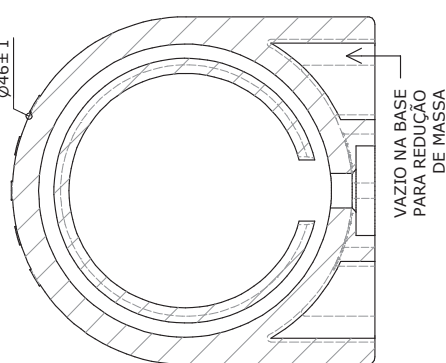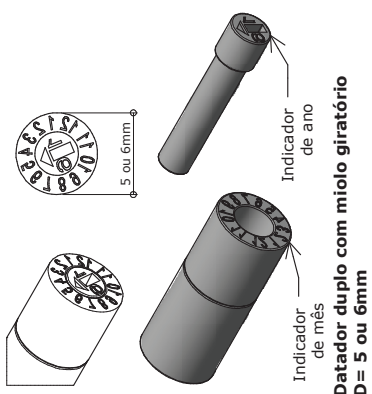

CORTE BB
ESC. 1 : 1

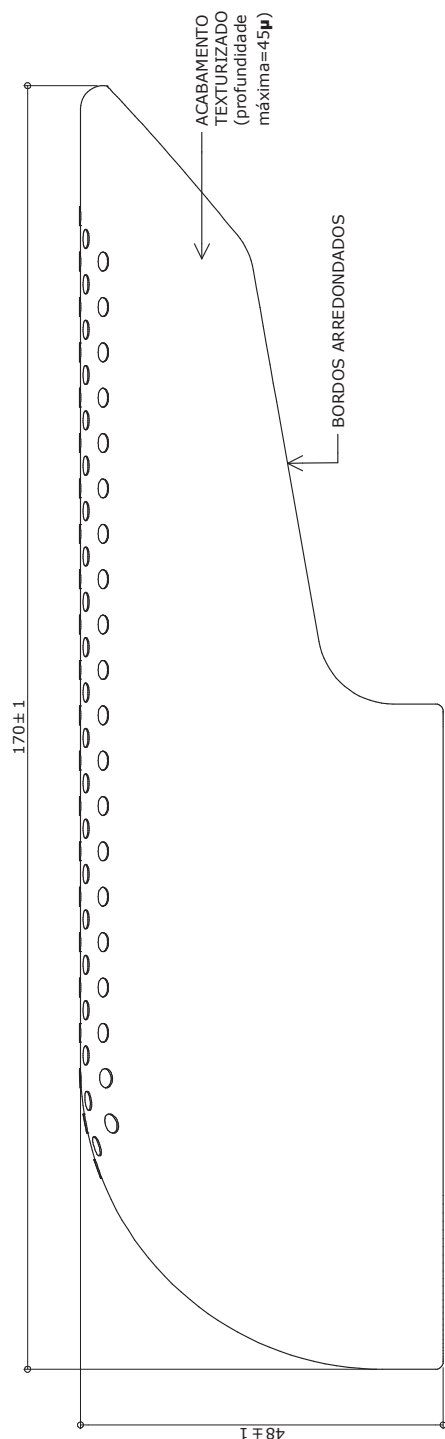

VISTA LATERAL
ESC. 1 : 1

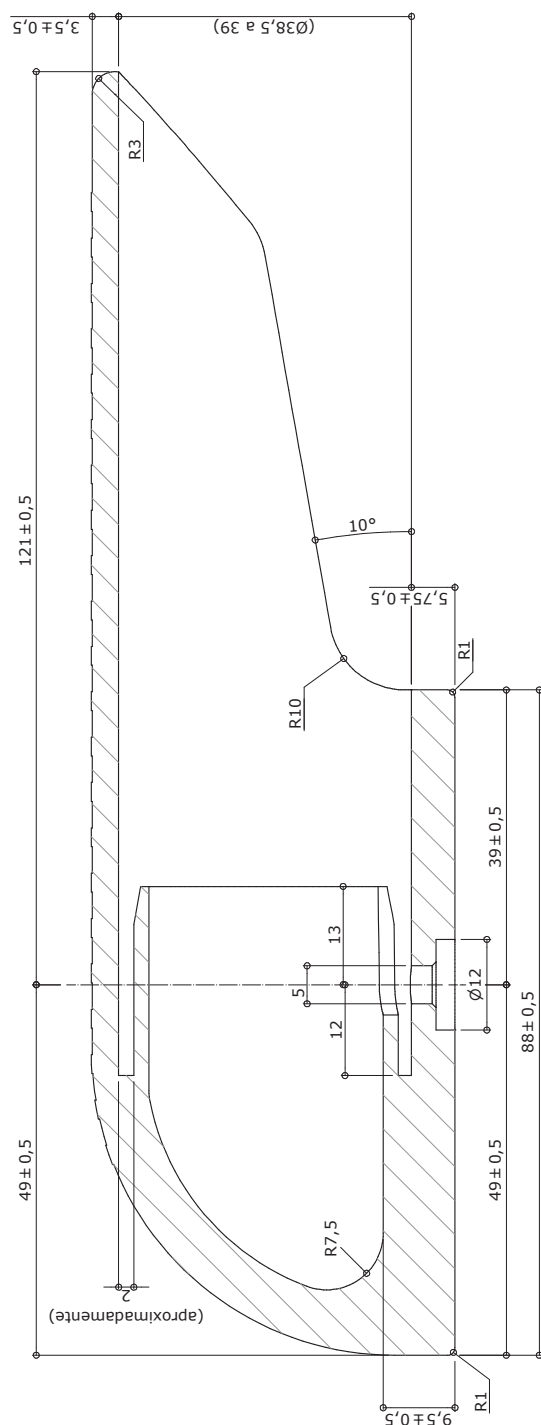

CORTE AA
ESC. 1 : 1

MA-02 FDE




Mesa
acessível
para pessoa
em cadeira
de rodas
(PCR)

Revisão 4
Data 31/07/17

Página
10/12

Atenção
Preserve a escala
Quando for imprimir, use
folhas A4 e desabilite a
função "Fit to paper"

Respeite o Meio Ambiente.
Imprima somente o ne-
cessário

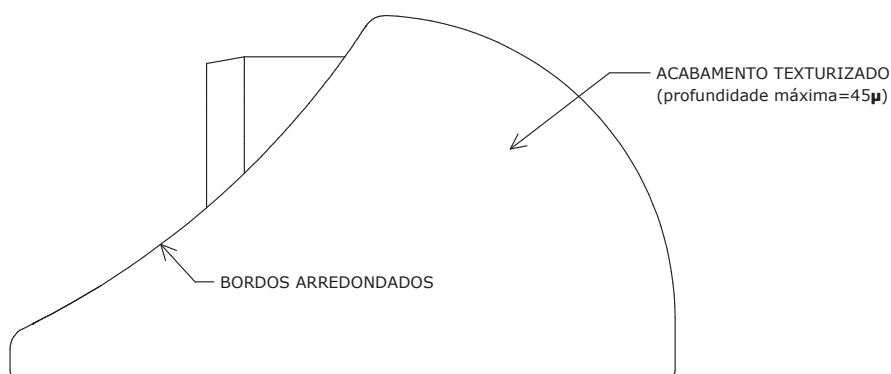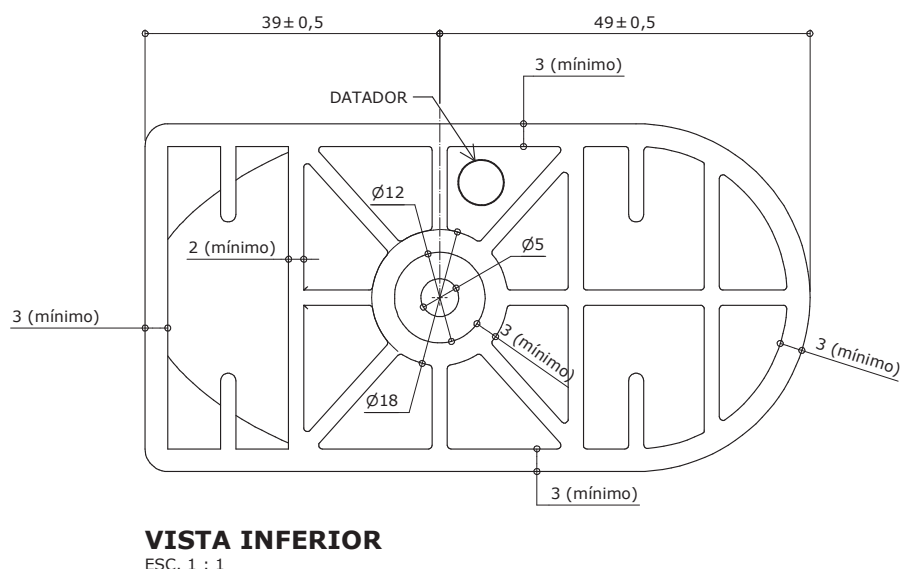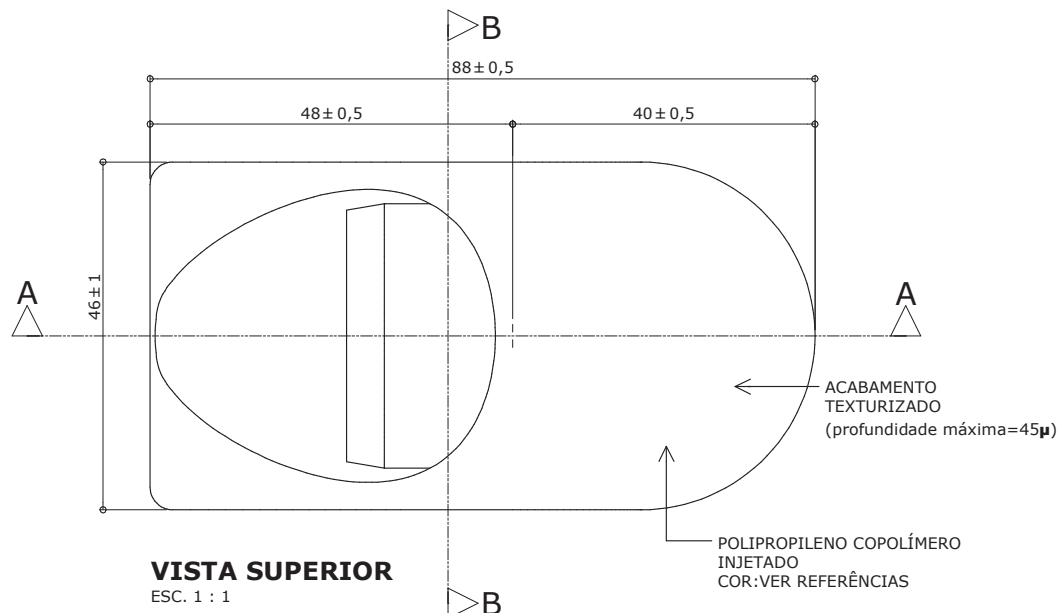


Obs: Retirar amostra do padrão de textura.


* Projeto FDE com cessão de uso ao FNDE conforme Acordo de Cooperação Técnica (D.O.U. 25/03/2009)
medidas em milímetros




VISTA FRONTAL
ESC. 1 : 1

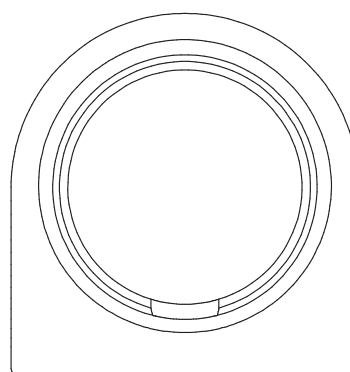

VISTA POSTERIOR
ESC. 1 : 1

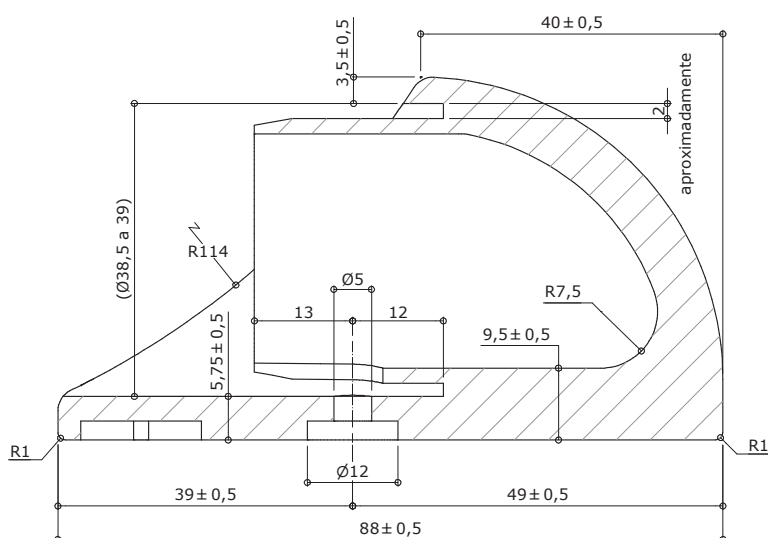

CORTE AA
ESC. 1 : 1

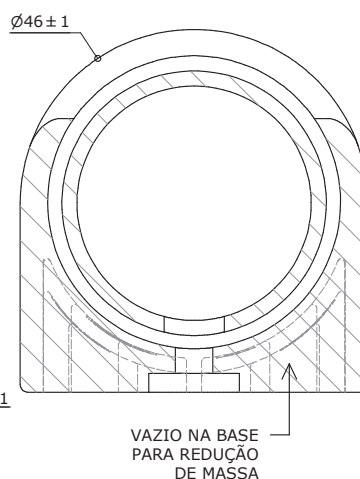

CORTE BB
ESC. 1 : 1

MA-02 FDE

**Mesa
acessível
para pessoa
em cadeira
de rodas
(PCR)**

Revisão 4
Data 31/07/17

Página
11/12



Apresentar em relevo no material injetado a seguinte informação:




nome do fabricante
do componente

Identificação do Modelo

Datador conforme figura abaixo:



**Datador duplo com miolo giratório
D= 5 ou 6mm**



Indicador
de mês

Indicador
de ano



Atenção
Preserve a escala
Quando for imprimir, use
folhas A4 e desabilite a
função "Fit to paper"

Respeite o Meio Ambiente.
Imprima somente o ne-
cessário

MA-02 FDE

Mesa
acessível
para pessoa
em cadeira
de rodas
(PCR)


Revisão 4
Data 31/07/17

Página
12/12




Atenção
Preserve a escala
Quando for imprimir, use
folhas A4 e desabilite a
função "Fit to paper"

Respeite o Meio Ambiente.
Imprima somente o ne-
cessário

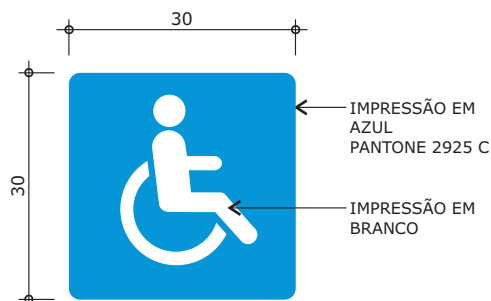

SÍMBOLO INTERNACIONAL DE ACESSO (SIA)
ESC. 1:1

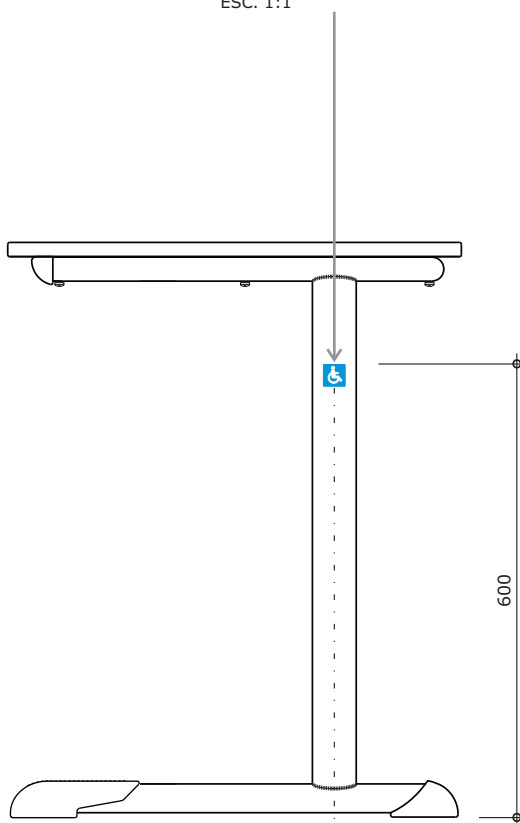

SÍMBOLO (SIA) CENTRALIZADO
EM RELAÇÃO AO TUBO

APLICAÇÃO DA INDICAÇÃO DE ACESSIBILIDADE
VISTA LATERAL DIREITA DA MESA
ESC. 1:10