


SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE			
Tipo do Documento	FLUXO		FLX.CME.001 – Página 1/2
Título do Documento	<b>FLUXO PARA DESINFECÇÃO DA VISEIRA PÓS USO EM PACIENTE SUSPEITO OU CONFIRMADO COVID-19</b>		Emissão: 26/03/2020
			Próxima revisão: 26/03/2022
		Versão: 1	

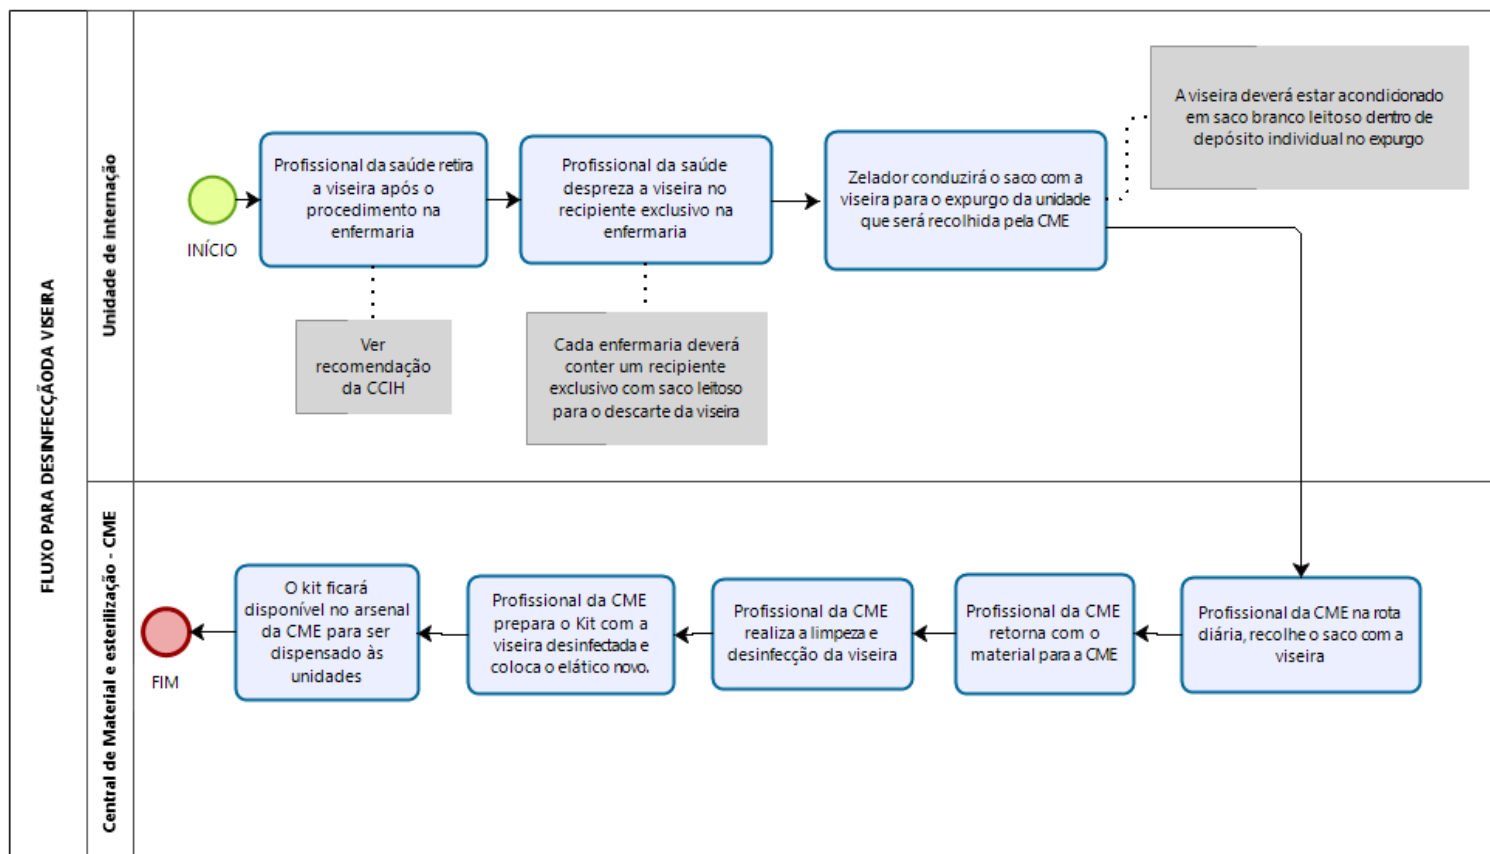

VERSÃO	DATA	DESCRIÇÃO DA ALTERAÇÃO

**SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE**

Tipo do Documento	<b>FLUXO</b>	FLX.CME.001 – Página 2/2	
Título do Documento	<b>FLUXO PARA DESINFECÇÃO DA VISEIRA PÓS USO EM PACIENTE SUSPEITO OU CONFIRMADO COVID-19</b>	Emissão: 26/03/2020 Versão: 1	Próxima revisão: 26/03/2022

Elaboração: Eliana de Goes Resende, Enfermeira Chefe Central de Material e Esterilização. Saionara Leal Ferreira, Enfermeira Assistencial.	26/03/2020
Análise: Paula Manuela Rodrigues Pinheiro Bertoncini, Coordenadora do Serviço de Avaliação e Monitoramento da Qualidade HUWC	26/03/2020
Aprovação: Rita Paiva Pereira Onório, Chefe da Divisão de Gestão do Cuidado	26/03/2020
Aprovação: Mona lisa Menezes Bruno, Chefe de Gestão da Qualidade e Vigilância em Saúde	26/03/2020