



Hospital de
Clínicas



HOSPITAL DE CLÍNICAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIÂNGULO MINEIRO

Avenida Getúlio Guaritá, nº 130 - Bairro Abadia

Uberaba-MG, CEP 38025-440

- <http://hcuftm.ebserh.gov.br/>

Ata - SEI nº 04/2025/CTEC/SUP/HC-UFTM-EBSEH

Uberaba, 11 de junho de 2025

LOCAL: Sala de Reuniões GEP CONECTA

HORÁRIO: 10:00 Horas

PARTICIPANTES:

NOME	CARGO
Luana Ribeiro Ferreira, como presidente	Fisioterapeuta da Unidade de Gestão da Qualidade e Segurança do Paciente
Raquel Bessa Ribeiro Rosalino	Enfermeira Gerente de Risco Sanitário
Carlos Batista Miranda Neto	Chefe do Setor de Engenharia Clínica
Fernanda América da Silva Morais	Chefe da Unidade de Almoarifado e Controle de Estoques
Alessandra Maria de Andrade	Chefe da Unidade de Planejamento e Dimensionamento de Estoques
Bruno Pacheco Resende	Assistente Administrativo da Unidade de Almoarifado e Controle de Estoques
Arnaldo José Custódio Neto	Enfermeiro Responsável Técnico da Central de Equipamentos HC/UFTM
Anderson Luiz Moretti	Assistente Administrativo da Unidade de Planejamento e Dimensionamento de Estoques
Tatiana Miranda Rodrigues	RT de Enfermagem da Unidade de Bloco Cirúrgico e Processamento de Material Esterelizado
Márcia Borges de Lima Félix	Assistente Administrativo da Unidade de Gestão da Qualidade e Segurança do Paciente

Abertura e Pautas da Reunião:

Pautas da Reunião:

Desabastecimento

Produtos Notificados

Queixa técnica

Produtos/Materiais em monitoramento
Manutenção preventiva

DESENVOLVIMENTO

Desabastecimento

Luana apresenta os produtos em desabastecimento no hospital em abril e maio:

Tampa protetora de AVP	✓
Pilha	
Curativo Transparente – Tegaderm	
Gaze estéril	✓
Agulha Hubber	
Seringa de 10 e 20 ml	✓
Three way	✓
Bolsa de colostomia	
Manta térmica	
Cateter tipo óculos	
Placa eletrocirúrgica	
Compressa estéril	✓
Campo cirúrgico steri drape	

DESABASTECIMENTO

Está regularizado o abastecimento dos seguintes produtos: Tampa protetora de AVP, gaze estéril, seringa de 10 e 20 ml, three way, bolsa de colostomia, manta térmica, compressa estéril, pilha e campo cirúrgico.

O curativo transparente está regularizado em 2 tamanhos.

A gaze está regularizada, mas está racionada, a empresa só vai entregar no final do mês, o que está em uso, foi conseguido por empréstimo.

O pregão da agulha hubber foi fracassado.

Alessandra informa a necessidade de dispensação da bota de unna, porque foi adquirida uma grande quantidade em compra emergencial.


Raquel refere que como a gaze estéril está em falta, se poderia utilizar a gaze não estéril esterilizada pela CME, como plano de contingência. Coloca que deve ser feita uma consulta à CME para ver a disponibilidade de esterilização desse material.

O cateter tipo óculos foi regularizado, mas está racionado.

A placa eletrocirúrgica está com o pregão aprovado, apenas aguardando aprovação do colex para fazer o pedido com previsão de mais ou menos 30 dias para entregue, ainda tem estoque para um mês.

Produtos Notificados

Luana apresenta os produtos notificados com queixa técnica em abril.

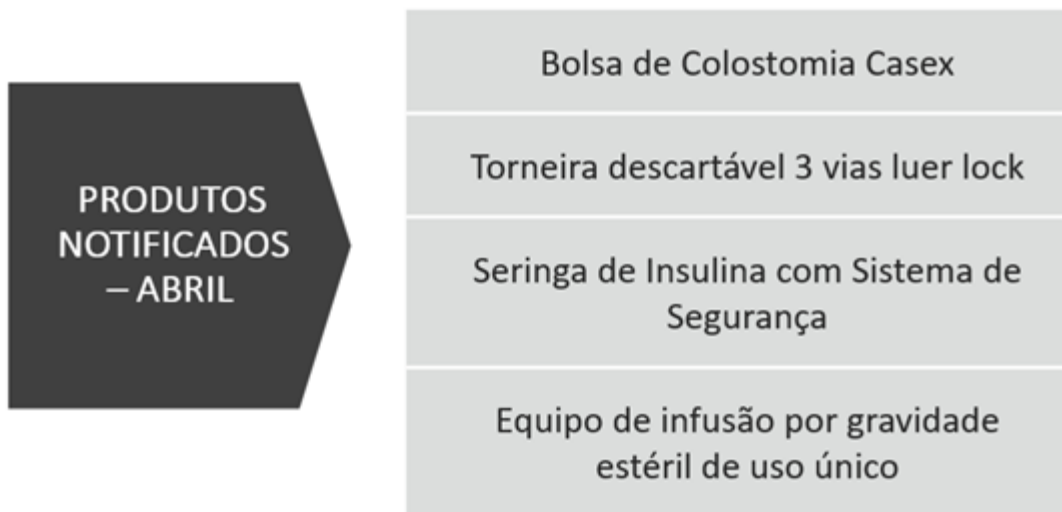

Bolsa de colostomia Casex .

Torneira descartável 3 vias luer lock – Foram recebidas várias notificações, vão ser substituídas.

Seringa de insulina – A empresa solicitou um vídeo demonstrando a flexibilidade de seringa, porém as unidades ainda não gravaram.

O equipo de infusão por gravidade estéril de uso, será substituído por outra marca.

Luana sugere colocar no descanso de tela, alertas com os produtos notificados que serão substituídos.

Produtos em Monitoramento

Luana apresenta os produtos em monitoramento:

Produto	Lote	Marca / Empresa
Torneira descartável de 3 vias luer lock, lars medicare pvt ✓	240448	Lars medicare Pvt
SAFECATH KIT para cateter venoso central de lúmen duplo	2024060007	SAFECATH
Equipo Infusomat Plus para nutrição enteral	24M051B615	Bbraun
dreno de sucção 4,8mm	25340711	SEROPLAST
Espadrappo CREMER	8563503A	CREMER
Cateter PICC Biomedical 1,9Fr. Registro na ANVISA 10196320051		Biomedical
SERINGA 60ML LUER LOCK	SSSAAB005B	DESCARPACK

EM MONITORAMENTO

Luana refere que foram notificações isoladas, são aguardadas novas notificações, se não aparecerem,

o vigihosp é encerrado.

Luana apresenta o monitoramento dos equipamentos da manutenção preventiva:



Pendências com a Engenharia Clínica

Luana apresenta as pendências relacionadas com a Engenharia Clínica:

Engenharia Clínica

- Contrato com empresa especializada para manutenção preventiva e corretiva de equipamentos (p. ex. Monitor Multiparamétrico, VM)
- Adequação do uso do berço aquecido novo
- Máquinas de hemodiálise

Luana refere que existe uma queixa relacionada aos cabos do monitor multiparamétrico.

Arnaldo refere que o cabo para reposição não está em falta.

Carlos diz que houve um problema com a caixinha na qual encaixam os cabos, mas foi solicitada a

troca das caixinhas e o problema foi regularizado.

Luana reporta uma queixa em relação ao desabastecimento de bomba de seringa.

Carlos diz que a seringa funciona, a marca está compatível, porém ao utilizar não funciona.

Carlos relata que será feita a adequação dos berços aquecidos, vai ser contratada uma empresa terceirizada para trocar a voltagem dos berços e comprar uma bandeja adequada para adaptação nesses berços.

Carlos reporta que a empresa terceirizado trouxe 4 equipamentos de reserva para hemodiálise, até chegarem os novos equipamentos.

Padronização

Luana apresenta os produtos pendentes de padronização:



Raquel diz que o saco plástico para RN não tem padronização no hospital, sendo necessário estudar qual o descritivo mais apropriado.

Fernanda informa que o hospital conseguiu um quantitativo de colar cervical por doação.

Raquel relata que a bandagem elástica adesiva e a sonda de levine curta são usadas na UTI Neonatal e Pediátrica, sendo importante para o hospital, a padronização desses materiais.

Raquel reforça, que com a abertura da residência de psiquiatria, faz-se necessária a padronização dos dispositivos para contenção mecânica.

Conclusões e Deliberações

- Apresentação dos produtos em desabastecimento e monitoramento no hospital e dos produtos com queixas técnicas;
- Apresentação do monitoramento da manutenção preventiva e corretiva;
- Apresentação e discussão das pendências com a Engenharia Clínica;
- Apresentação de equipamentos com necessidade de padronização no HC/UFTM.

Nada mais tendo a acrescentar, apresentamos nossa concordância com os termos da presente ata.

Luana Ribeiro Ferreira
Fisioterapeuta da Unidade de Gestão da Qualidade e Segurança do Paciente



Documento assinado eletronicamente por **Marcia Borges de Lima Felix, Membro do Comitê**, em 27/06/2025, às 14:39, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Carlos Batista Miranda Neto, Membro do Comitê**, em 27/06/2025, às 17:02, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Luana Ribeiro Ferreira, Membro do Comitê**, em 30/06/2025, às 08:19, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Fernanda America da Silva Moraes, Membro do Comitê**, em 30/06/2025, às 10:50, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Raquel Bessa Ribeiro Rosalino, Membro do Comitê**, em 30/06/2025, às 15:52, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Arnaldo Jose Custodio Neto, Membro do Comitê**, em 01/07/2025, às 08:41, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Alessandra Maria de Andrade, Membro do Comitê**, em 02/07/2025, às 13:34, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Anderson Luiz Moretti, Assistente Administrativo**, em 02/07/2025, às 14:34, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Bruno Pacheco Resende, Assistente Administrativo**, em 03/07/2025, às 10:28, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Tatiana Miranda Rodrigues, Enfermeiro(a)**, em 03/07/2025, às 10:40, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.ebserh.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **50827947** e o código CRC **B8BEECEF**.

Referência: Processo nº 23521.016901/2024-15 SEI nº 50827947

Criado por [marcia.bfelix](#), versão 2 por [marcia.bfelix](#) em 27/06/2025 14:39:36.