



Hz

Ω

λ

V

CT-08

Comissão Técnica Eletro-Eletrônica

SUBCOMISSÃO DE CALIBRAÇÃO


Coordenadora: **Rima Yehia**

Secretário: **Fabrício Gonçalves Torres**

08.02.2017

CT-08 COMISSÃO TÉCNICA ELETRO-ELETRÔNICA


SUBCOMISSÃO DE CALIBRAÇÃO

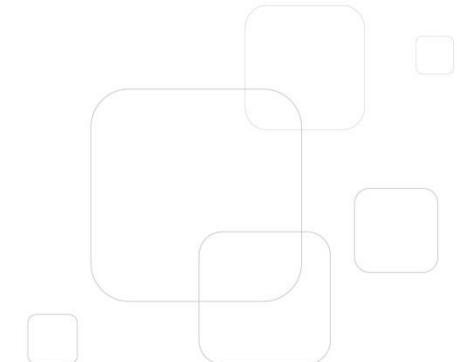

■ Números

- 13 membros (12 Instituições) enviaram o FOR-Cgcre-78 preenchido.
- 14 Instituições estão participando das atividades de ensaio de proficiência.
- 26 nomes no *mailing* de comunicação.
- 13 participantes na última reunião + 03 com ausência justificada.
- 78 Laboratórios acreditados pela Cgcre em Eletricidade.
Fonte: http://inmetro.gov.br/laboratorios/rbc/lista_laboratorios.asp?acao=consulta , em 03.02.2017


CT-08 COMISSÃO TÉCNICA ELETRO-ELETRÔNICA
SUBCOMISSÃO DE CALIBRAÇÃO

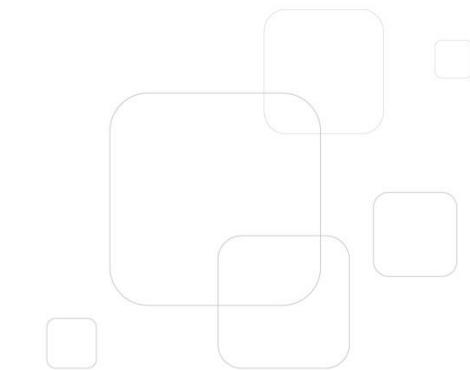

■ **Atividades realizadas em 2016**

- Jun./2016 – Reunião no IPT para apresentar resultado de uma pesquisa, discutir um plano de trabalho e planejar um ensaio de proficiência.
- Jul./2016 – Envio da Ata da Reunião.
- Ago./2016 – Envio da Carta-Convite para participação de um Programa de Comparação Interlaboratorial em Tensão, Corrente e Potência AC (PCI).
- Out./2016 – Correção da Carta-Convite em função de alteração do modelo do artefato e envio do cronograma do PCI.

CT-08 COMISSÃO TÉCNICA ELETRO-ELETRÔNICA
SUBCOMISSÃO DE CALIBRAÇÃO

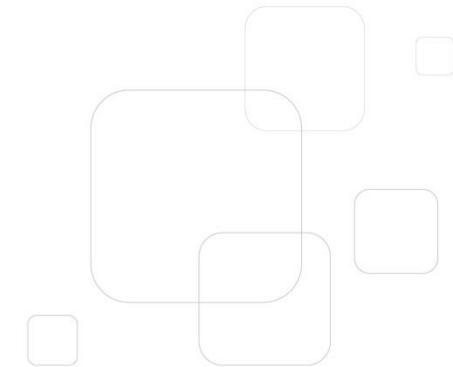

■ **Atividades realizadas em 2016**

- Out./2016 – Ajuste do cronograma em função das solicitações dos participantes.
- Nov./2016 – Envio de nova versão do Protocolo do PCI e de uma máscara para a Planilha de Resultados.
 - Início do PCI.


Cronograma do Ensaio de proficiência nº 793/16 (Versão 3)

Ordem	Instituição	Data de Recebimento do Item
1	CTM	31/10/2016
2	Elus	07/11/2016
3	Empteq	16/11/2016
4	MEC-Q	23/11/2016
5	Sigtron	30/11/2016
6	WEG	07/12/2016
7	Microprecs	14/12/2016
8	Socintec	21/12/2016
9	Yokogawa	04/01/2017
10	Medição Soluções	11/01/2017
11	Gero	18/01/2017
12	IPT	26/01/2017
13	IEE	02/02/2017
14	Metracal	09/02/2017
15	CTM	16/02/2017

Cerca de 2
semanas de
atraso

CT-08 COMISSÃO TÉCNICA ELETRO-ELETRÔNICA


SUBCOMISSÃO DE CALIBRAÇÃO

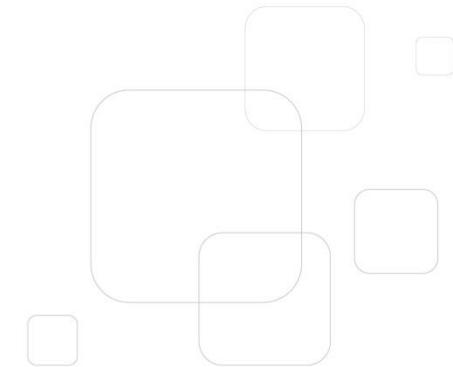

■ **Plano para 2017**

- Analisar os resultados do PCI, emitir o relatório final e fazer uma reunião para apresentação dos resultados.
- Planejar outros ensaios de proficiência.
- Verificar a continuidade da proposta de elaboração de uma minuta de documento orientativo para calibração de alicates amperímetros.
- Discutir outros assuntos de interesse dos membros.

CT-08 COMISSÃO TÉCNICA ELETRO-ELETRÔNICA
SUBCOMISSÃO DE CALIBRAÇÃO

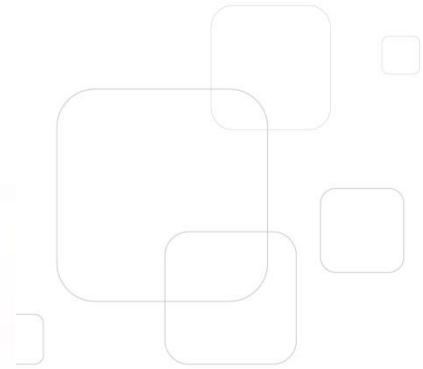

Rima Yehia

Laboratório de Metrologia Elétrica - IPT

Tel. (11) 3767-4948 – E-mail: rima@ipt.br